


SCHWINGGESCHWINDIGKEIT

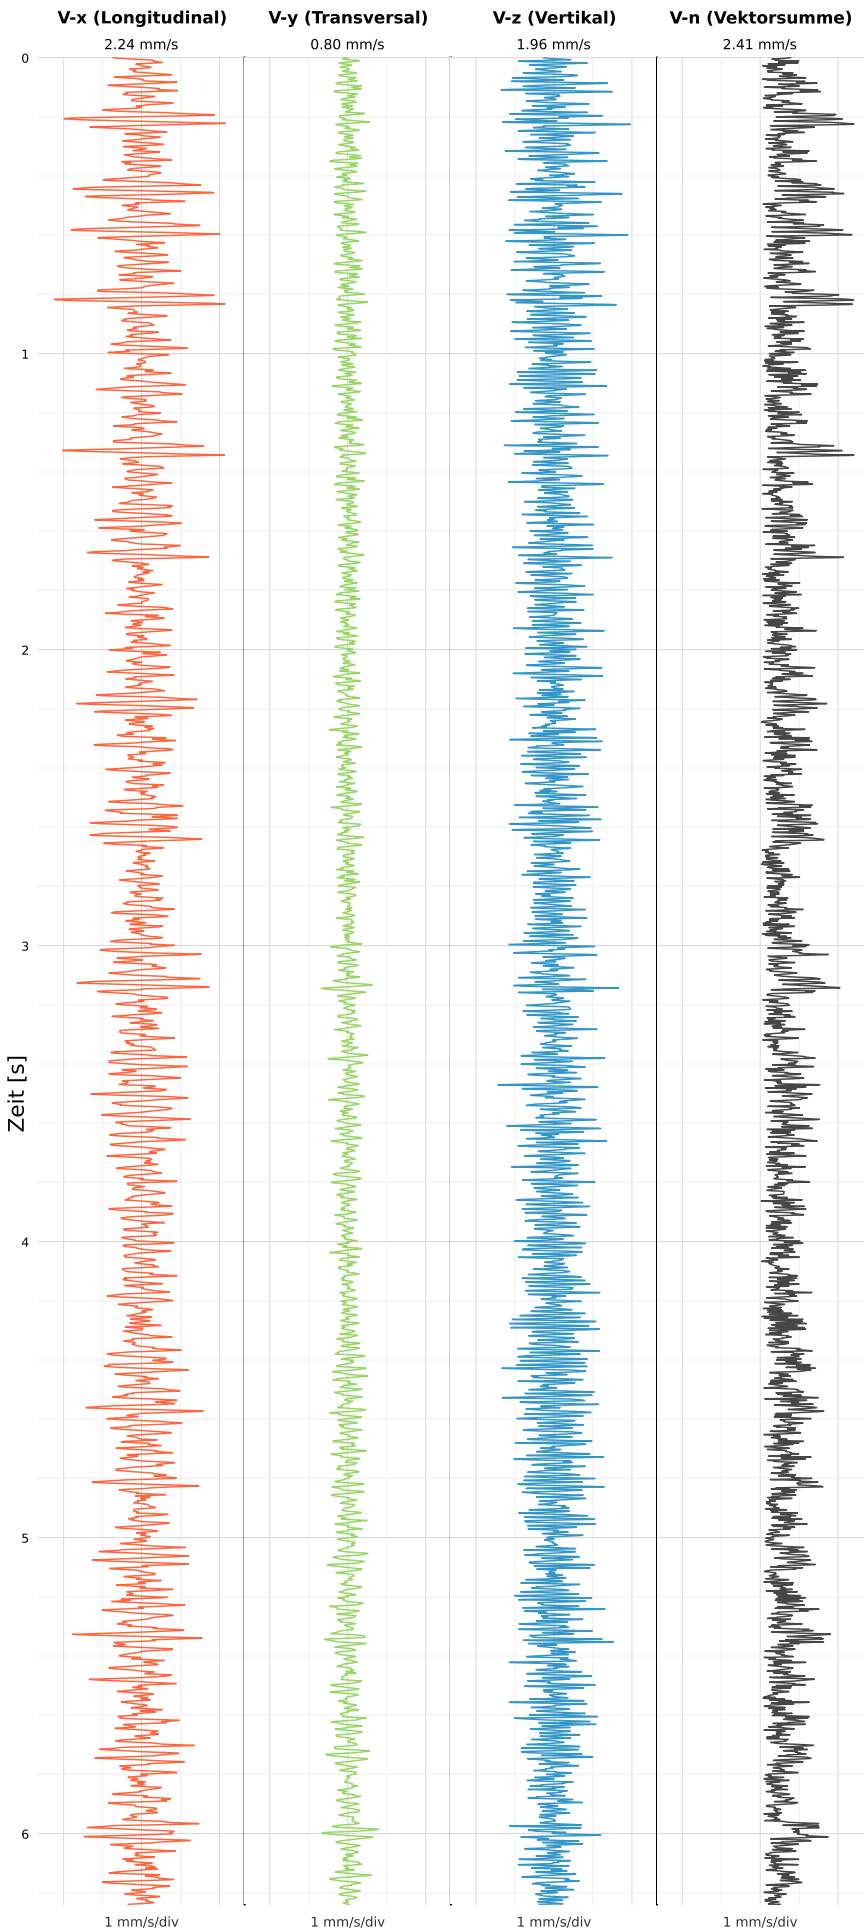


DATEI: 2492-PG14-09062026-071302_raw.csv

Aufzeichnungsdauer: 6.24 s | Abtastrate: 1000 Hz

Datum:	09.06.2026	
Zeit:	07:13:02	
Event-ID:	2492-PG14-09062026-071302	
Kalibrier Datum:	12.07.2025	
Spitzwerte		
V-x (Longitudinal)	V-y (Transversal)	V-z (Vertikal)
2.24 mm/s	0.80 mm/s	1.96 mm/s
29.5 Hz	43.3 Hz	72.0 Hz
22.73% von Limit	5.99% von Limit	11.39% von Limit
V-n (Vektorsumme): 2.41 mm/s		

SPEKTRALANALYSE - KOMPONENTEN FFT

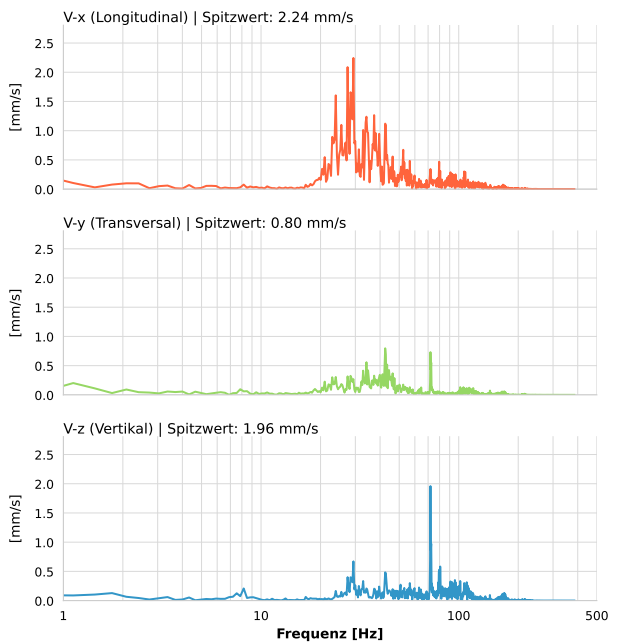

SPEKTRALANALYSE - FFT (DIN 4150-3)

