


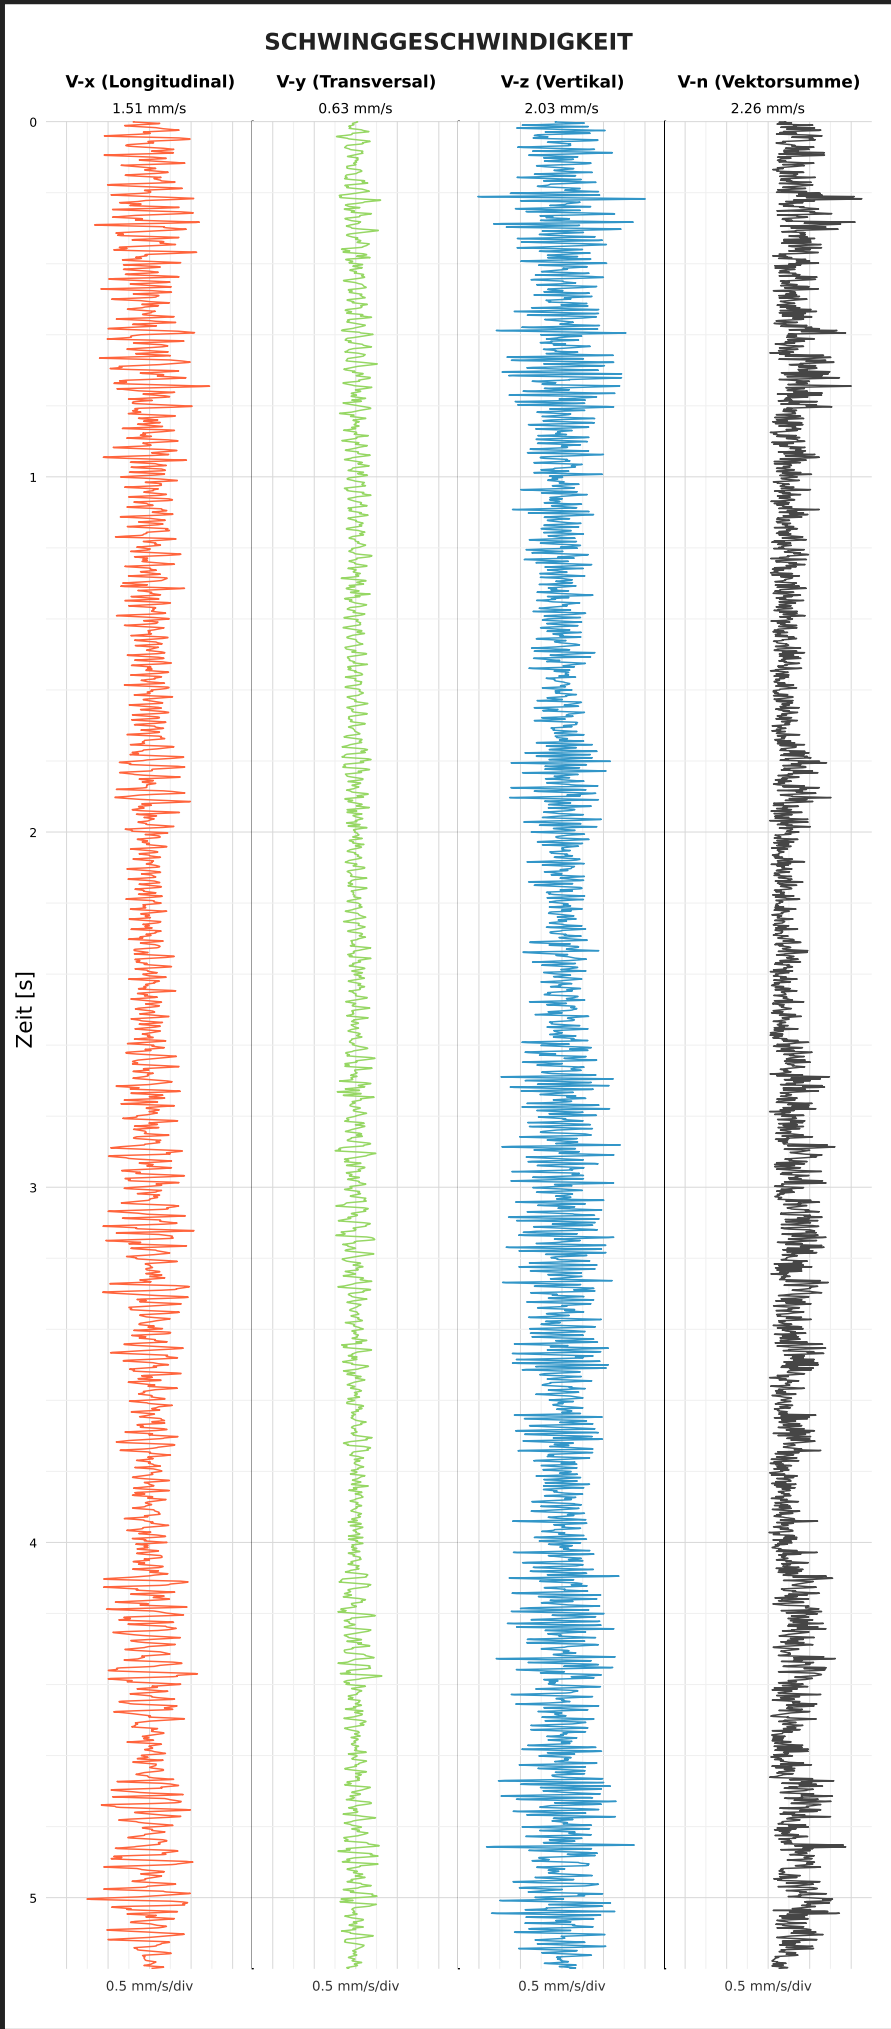

DATEI: 2492-PG14-11062026-081522_raw.csv

Aufzeichnungsdauer: 5.20 s | Abtastrate: 1000 Hz

Datum:	11.06.2026	
Zeit:	08:15:22	
Event-ID:	2492-PG14-11062026-081522	
Kalibrier Datum:	12.07.2025	

Spitzwerte		
V-x (Longitudinal)	V-y (Transversal)	V-z (Vertikal)
1.51 mm/s	0.63 mm/s	2.03 mm/s
45.4 Hz	36.2 Hz	70.0 Hz
10.90% von Limit	5.45% von Limit	11.92% von Limit

V-n (Vektorsumme): 2.26 mm/s

SPEKTRALANALYSE - KOMPONENTEN FFT

V-x (Longitudinal) | Spitzwert: 1.51 mm/s

V-y (Transversal) | Spitzwert: 0.63 mm/s

V-z (Vertikal) | Spitzwert: 2.03 mm/s

Kanal	Spitzwert	Spektrum 25%	Spektrum 50%	Spektrum 75%
X	1.51 mm/s	35.6 Hz	51.3 Hz	93.3 Hz
Y	0.63 mm/s	32.1 Hz	46.3 Hz	100.6 Hz
Z	2.03 mm/s	51.3 Hz	88.3 Hz	109.8 Hz

SPEKTRALANALYSE - FFT (DIN 4150-3)